




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Българска агенция по безопасност на храните

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

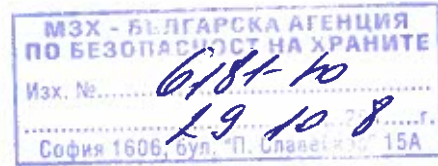

Относно: Искане за представяне на разяснения по обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на real-time PCR апарат за нуждите на НРЛ „КЧС, АЧС и Каприпоксвируси“ към ИДНИВМИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в Българска агенция по безопасност на храните писмо вх. № 15509/26.10.2018 г. от потенциален участник с искане за предоставяне на разяснения по горе цитираната обществена поръчка, даваме следните разяснения на заинтересованите участници:

Въпрос № 1: „Съгласно техническата спецификация към документацията за участие, Възложителят е поставил изискване оферираният апарат да е с реакционен обем 10-50 мкл. или по-широк обхват. Възложителят ще приеме ли за участие оферта за апарат с обхват на реакционния обем в диапазон от 10 до 30 мкл. предвид на това, че е с по-висока чувствителност?“

Отговор № 1: Възложителят ще приеме за участие оферта за апарат с различен от изискуемия в техническата спецификация обхват на реакционния обем, с приложено доказателство за по-висока чувствителност.

Въпрос № 2: „Съгласно техническата спецификация към документацията за участие, Възложителят е поставил изискване оферираният апарат да е с температурна хомогенност: $\pm 0,04^{\circ}\text{C}$ или по-добра. Моля Възложителят да уточни дали не е допусната техническа грешка и показателят за температурна хомогенност следва да се разбира $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$?“

Отговор № 2: Допусната е техническа грешка в техническата спецификация, температурната хомогенност следва да се чете $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ или по-добра.“

С уважение,

Д-Р ДАМЯН ИЛИВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕ



ср. 2, ал. 1
от ЗЗРА